



CNAS-R01

认可标识和认可状态声明管理规则

**Rules for the Use of Accreditation Symbols and
Reference to Accreditation**

中国合格评定国家认可委员会

认可标识和认可状态声明管理规则

1.目的与范围

1.1 为保证 CNAS 徽标、国际互认联合徽标、认可标识、国际互认联合标识与认可证书的正确使用，防止误用、滥用徽标、标识和误导性宣传，维护 CNAS 的信誉，特制定本规则。

1.2 本规则适用于 CNAS 徽标、国际互认联合徽标、认可标识、国际互认联合标识与认可证书的管理，规范获准认可的机构对认可标识的使用及认可状态的宣传。

2.引用文件

下列文件中的条款通过引用而成为本文件的条款。以下引用的文件，注明日期的，仅引用的版本适用；未注明日期的，引用文件的最新版本（包括任何修订）适用。

- 2.1 ISO/IEC 17011: 2004 《合格评定 认可机构通用要求》
- 2.2 ISO/IEC 17000: 2004 《合格评定 术语和总则》
- 2.3 ISO/IEC 导则 2: 2004 《标准化和相关合格评定活动通用术语》
- 2.4 IAF ML 2: 2004 《IAF 国际互认标识使用通则》
- 2.5 ILAC—P8 《ILAC-MRA 补充要求以及已认可实验室使用认可标识和声明认可状态的指南》
- 2.6 《IAF MLA 国际互认标识许可协议》
- 2.7 《ILAC-MRA 国际互认标识许可协议》
- 2.8 CNAS—RC01 《认证机构认可规则》
- 2.9 CNAS—RL01 《实验室认可规则》
- 2.10 CNAS—RI01 《检查机构认可规则》

3.术语和定义


本规则引用 ISO/IEC 导则 2、ISO/IEC17000 和 ISO/IEC17011 中的有关术语并采用下列定义：

- 3.1 **CNAS 徽标**: 代表 CNAS 机构本身的图形标识。
- 3.2 **认可标识**: CNAS 颁发的、供获准认可的机构使用的、表示其认可资格的图形标识。
- 3.3 **认可状态声明**: 用以表示认可资格的文字说明。
- 3.4 **认可制度**: CNAS 实施认可活动的规则、准则、程序和管理。
- 3.5 **注册号**: CNAS 授予获准认可的机构的唯一性代码。
- 3.6 **IAF-MLA 国际互认标识**: 国际认可论坛 (IAF) 表明相关国家 (或经济体) 认可机构所实施的认可制度已正式签署了多边互认协议的图形标识, 简称 IAF-MLA 标识。
- 3.7 **ILAC-MRA 国际互认标识**: 国际实验室认可合作组织 (ILAC) 表明相关国家 (或经济体) 认可机构所实施的认可制度已正式签署了多边互认协议的图形标识, 简称 ILAC-MRA 标识。
- 3.8 **IAF-MLA/CNAS 国际互认联合徽标**: 由 IAF-MLA 国际互认标识和 CNAS 徽标共同组成的图形标识, 简称 IAF-MLA/CNAS 联合徽标。
- 3.9 **ILAC-MRA/CNAS 国际互认联合徽标**: 由 ILAC-MRA 国际互认标识和 CNAS 徽标共同组成的图形标识, 简称 ILAC-MRA/CNAS 联合徽标。
- 3.10 **IAF-MLA/CNAS 国际互认联合标识**: 由 IAF-MLA 国际互认标识和认可标识共同组成的图形标识, 简称 IAF-MLA/CNAS 联合标识。
- 3.11 **ILAC-MRA/CNAS 国际互认联合标识**: 由 ILAC-MRA 国际互认标识和认可标识共同组成的图形标识, 简称 ILAC-MRA/CNAS 联合标识。
- 3.12 **认可证书**: CNAS 颁发给获准认可的机构, 表明所确定的范围已被认可的一组正式文件, 包括符合特定认可准则的证明和认可范围附件。
- 3.13 **授权签字人**: 经 CNAS 认可, 可以签发带认可标识的实验室或检查机构报告或证书和声明认可状态文件的人员。
- 3.14 **认可标识章**: CNAS 颁发给获准认可的实验室或检查机构, 供其在认可范围内出具的报告/证书上加盖的印章。
- 3.15 **校准标签**: 校准实验室在被校准的器具上加贴的标明校准状态的标识。
- 3.16 **实验室**: 指检测、校准实验室, 也包括能力验证提供者、标准物质/标准样品生产者等机构。

4. 徽标的管理

4.1 CNAS 徽标

4.1.1 CNAS 徽标的式样

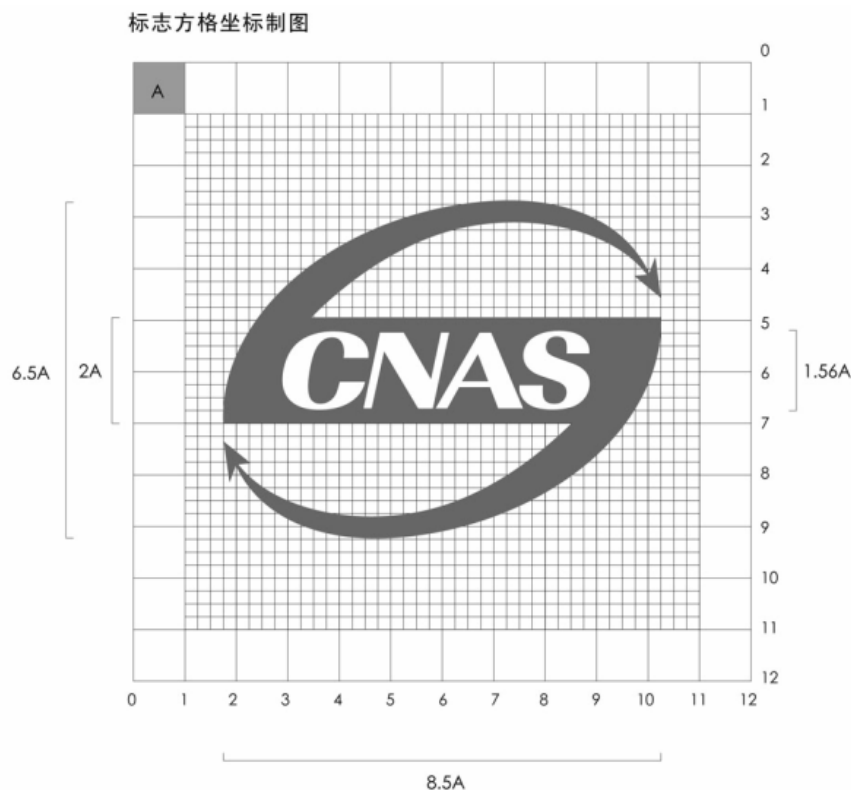

4.1.2 CNAS 徽标的规格

CNAS 徽标的规格如图，可成比例放大缩小，应清晰可辨。

4.1.3 CNAS 徽标的颜色

CNAS 徽标的基本颜色为蓝色或黑色。

蓝色：C: 100 M: 80 Y: 0 K: 0 （标准色）。

黑色：C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 （标准色）。

4.1.4 CNAS 徽标的使用

4.1.4.1 CNAS 具有唯一的徽标，拥有其所有权和使用权，并受法律保护，其他机构和个人未经 CNAS 的书面允许不得使用 CNAS 徽标。

4.1.4.2 CNAS 徽标可用于 CNAS 认可证书、公开出版物、文件、办公用品、宣传品、网页宣传等，可采用印刷和电子图文等方式使用。

4.1.4.3 在特定情况下，CNAS 徽标也可以使用除基本颜色以外的其他单一颜色。

4.2 IAF- MLA/CNAS 联合徽标

4.2.1 IAF-MLA/CNAS 联合徽标由 IAF-MLA 标识和 CNAS 徽标并列组成，式样如下：



4.2.2 国际认可论坛 (IAF)拥有 IAF-MLA 标识的所有权。

4.2.3 CNAS 是国际认可论坛(IAF)和太平洋认可合作组织(PAC)多边承认协议(MLA)成员，并与 IAF 签署了《IAF MLA 国际互认标识许可协议》，可以在规定的范围内使用 IAF-MLA 标识。CNAS 拥有 IAF-MLA 联合徽标使用权，CNAS 不允许其他任何机构使用该徽标，也不授权其他机构使用。

4.3 ILAC- MRA/CNAS 联合徽标

4.3.1 ILAC-MRA/CNAS 联合徽标由 ILAC-MRA 标识和 CNAS 徽标并列组成，式样如下：



4.3.2 国际实验室认可合作组织(ILAC)拥有 ILAC-MRA 标识的所有权。

4.3.3 CNAS 是国际实验室认可合作组织(ILAC)多边承认协议(MRA)成员，并与 ILAC 签署了《ILAC-MRA 国际互认标识许可协议》，可以在规定的范围内使用 ILAC-MRA 标识。CNAS 拥有 ILAC-MRA 联合徽标使用权。不允许其他任何机构使用该徽标，也不授权其他机构使用。

5.CNAS 认可标识的管理

5.1 CNAS 认可标识

CNAS 认可标识分为中文版和英文版，由 CNAS 徽标和标明认可制度的文字、注册号组成，文字和注册号置于 CNAS 徽标的正下方，使用 Arial 字体。

5.2 CNAS 认可标识式样

5.2.1 管理体系认证机构认可标识式样：



其中，“C”代表认证机构（CERTIFIER）认可，“XXX”为认可流水号，“Y”为认证领域代码，如：质量管理体系认证（QMS）使用字母“Q”，环境管理体系认证（EMS）使用字母“E”，职业健康安全管理体系认证（OHSMS）使用字母“S”，食品安全管理体系认证（FSMS/HACCP）使用字母“F”，信息安全管理体系认证（ISMS）使用字母“I”等。

5.2.2 产品认证机构认可标识式样：



其中，“C”代表认证机构（CERTIFIER）认可，“XXX”为认可流水号，“P”为产品认证（PRODUCT）领域代码（不包括有机产品认证）。

5.2.3 有机产品认证机构认可标识式样：



其中，“C”代表认证机构（CERTIFIER）认可，“XXX”为认可流水号，“O”为有机产

品认证（ORGANIC PRODUCT）领域代码。

5.2.4 服务认证机构认可标识式样：



其中，“C”代表认证机构（CERTIFIER）认可，“XXX”为认可流水号，“V”为服务认证（SERVICE）领域代码。

5.2.5 人员认证机构认可标识式样：



其中，“C”代表认证机构（CERTIFIER）认可，“XXX”为认可流水号，“R”为人员认证（PERSON）领域代码。

5.2.6 软件过程及能力成熟度评估机构认可标识式样：



其中，“A”代表评估机构（ASSESSMENT）认可，“XXX”为认可流水号，“S”为软件过程及能力成熟度评估（SPCA）领域代码。

5.2.7 检测实验室认可标识式样：



检测
CNAS LXXXX

中文版



TESTING
CNAS LXXXX

英文版

其中，“L”代表实验室（LABORATORY）认可，“XXXX”为认可流水号。

5.2.8 校准实验室认可标识式样：



校准
CNAS LXXXX

中文版



CALIBRATION
CNAS LXXXX

英文版

其中，“L”代表实验室（LABORATORY）认可，“XXXX”为认可流水号。

5.2.9 医学检测实验室认可标识式样：



医学检测
CNAS MTXXXX

中文版



MEDICAL TESTING
CNAS MTXXXX

英文版

其中，“MT”代表医学检测（MEDICAL TESTING）实验室认可，“XXXX”为认可流水号。

5.2.10 实验室生物安全认可标识式样：



生物安全
CNAS BLXXXX

中文版



BIOSAFETY
CNAS BLXXXX

英文版

其中，“BL”代表实验室生物安全（BIOSAFETY）认可，“XXXX”为认可流水号。

5.2.11 医学实验室安全认可标识式样：



中文版



英文版

其中，“MS”代表医学实验室安全（MEDICAL SAFETY）认可，“XXXX”为认可流水号。

5.2.12 检查机构认可标识式样：



中文版



英文版

其中，“IB”代表检查机构（INSPECTION BODY）认可，“XXXX”为认可流水号。

5.2.3 能力验证提供者认可标识式样：



中文版



英文版

其中，“PT”代表能力验证提供者（PROFICIENCY TESTING）认可，“XXXX”为认可流水号。

5.2.14 标准物质生产者认可标识式样：



中文版



英文版

其中，“RM”代表标准物质生产者（REFERENCE MATERIAL）认可，“XXXX”为认可流水号。

5.2.15 获得多个认可资格的机构需要在宣传认可资格时，综合使用认可标识（出具证书、报告除外），可采用以下示例的式样：



5.3 CNAS 认可标识的使用

5.3.1 CNAS 认可标识的使用通则

5.3.1.1 CNAS 拥有认可标识的所有权，并授权获准认可的机构在认可范围和认可有效期内按照本规则的规定使用认可标识。获准认可的机构应对认可标识的使用进行管理和控制，并不得将认可标识使用在与被认可的范围无关的其他业务中。CNAS 对获准认可机构的认可标识使用情况进行监督。

5.3.1.2 获准认可的实验室和检查机构拥有认可标识的使用权，并鼓励其在规定的范围内使用认可标识；获准认可的认证机构和评估机构拥有认可标识的使用权，并有权在 CNAS 允许的范围内授权获得认证的组织有条件使用认可标识(具体规定见本规则条款 5.3.2.3)并监督其使用情况。未经 CNAS 允许，不得转让认可标识使用权。

5.3.1.3 获准认可的机构应以认可证书上标注的机构名称（或 CNAS 同意的名称）或机构的徽标与认可标识一起使用。必要时，应标注追溯认可标识意义的途径或方法。

5.3.1.4 获准认可的机构在使用认可标识（包括印章和电子图形）时，应保证认可标识的完整，可按比例放大或缩小，但应确保认可标识的颜色与认可机构的徽标颜色一致并

清晰可辨；CNAS 向获准认可机构提供硬拷贝或电子版的认可标识式样。

5.3.1.5 获准认可的机构可以将认可标识用在报告、证书、文件、办公用品、宣传品、网页等，但不能用于报价单。可以采用印刷、图文和印章等使用方式。

5.3.1.6 认可标识的使用不应产生误导，使相关方误认为 CNAS 对获准认可的机构出具的证书和报告结果负责，或对此结果的意见或解释负责。

5.3.1.7 被暂停或缩小认可资格的机构在被暂停或缩小的范围内应立即停止任何关于获 CNAS 认可的宣传，并应立即停止在证书、报告、文件、宣传品上继续使用认可标识。

5.3.1.8 被撤销认可资格的机构应立即停止任何关于获 CNAS 认可的宣传，并应立即停止在证书、报告、文件、宣传品、办公用品等上继续使用认可标识。

5.3.1.9 如果获准认可的机构签发电子版本的带认可标识的证书或报告时，应建立特定的管理程序以保证符合本规则的规定。

5.3.1.10 当获准认可的机构因认可标识引起法律诉讼时，应及时通告 CNAS。

5.3.1.11 必要时，CNAS 将与获准认可的机构协商制定对认可标识使用的其他要求，并形成相关文件。

5.3.2 CNAS 认可标识在认证机构的使用

5.3.2.1 对于宣称获得 CNAS 认可的认证机构，应在其颁发的认证证书上使用 CNAS 的认可标识或“经中国合格评定国家认可委员会认可（Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment）”字样与认可注册号。

5.3.2.2 获准认可的认证机构在使用认可标识时应与本机构的名称或徽标在同一个页面。

5.3.2.3 获准认可的认证机构可以授权获得其认证的组织按照以下要求使用认可标识：

1) 认可标识应与认证机构的认证标志（包括注册号）并列使用，例如：



认证注册号



体系认证

CNAS CXXX - Q

2) 获准认可的认证机构应与获得认证的组织签署有关使用认可标识的协议并监督其

使用情况。

3) 当管理体系认证机构获准 CNAS 认可时, 认证机构不得允许获得认证的组织将 CNAS 认可标识用在组织生产的产品上。只有在符合 CNAS—CC12《质量管理体系认证机构通用要求》应用指南中 G3.7.4 规定的情况下, 认可标识才可以有条件地使用在产品的包装(不会到产品的最终用户手中, 如用于运输产品的大包装箱)或广告等上。

4) 当产品认证机构获准 CNAS 认可时, 认证机构可以允许获得认证的组织将认可标识用在获得认证的产品或单个包装上。

5.3.2.4 认可标识的使用不应使相关方误认为 CNAS 对获得认证的特定管理体系、产品、服务、人员或过程等进行了批准。

5.3.2.5 如果获准认可的认证机构向获证组织颁发“获证牌匾”时, 该牌匾中 CNAS 认可标识的使用应符合本规则的规定, 并应在正式使用前将“获证牌匾”样式提交 CNAS 备案。

5.3.3 CNAS 认可标识在实验室或检查机构的使用

5.3.3.1 获准认可的实验室或检查机构应将认可标识置于报告或证书首页上部适当的位置。

5.3.3.2 带认可标识的报告或证书应由授权签字人在其授权范围内签发。

5.3.3.3 同时获得检测和校准认可资格的实验室, 检测报告或证书应仅使用检测实验室认可标识, 校准报告或证书应仅使用校准实验室认可标识。

5.3.3.4 如果实验室或检查机构同时也通过管理体系认证, 报告或证书上只能使用认可标识, 而不得使用认证标志。

5.3.3.5 实验室或检查机构签发的报告或证书结果全部不在认可范围内或全部由分包方完成, 不允许在其报告或证书上使用认可标识。

5.3.3.6 实验室或检查机构签发的带认可标识的报告或证书中包含部分非认可项目时, 应清晰标明此项目不在认可范围内。

5.3.3.7 实验室或检查机构签发的带认可标识的报告或证书中包含部分分包项目时, 应清晰标明分包项目。如果分包方获得 CNAS 认可或获得与 CNAS 签署多边或双边互认协议的认可机构的认可, 从分包方的报告或证书中摘录信息应得到分包方的同意; 如果分包方未获认可应标明项目不在认可范围内。

5.3.3.8 实验室或检查机构签发的带认可标识的报告或证书中若含有符合某规范、标准或对结果解释的内容时, 应作必要的文字说明, 并明确所指规范、标准的完整标识或具体条款, 以避免客户产生歧义或误解。

5.3.3.9 实验室签发的带认可标识的报告或证书中包含意见或解释时，意见或解释获得 CNAS 认可，且意见或解释依据的检测、校准、检查等结果也应获得 CNAS 认可。如果意见或解释不在 CNAS 认可范围之内，应在报告或证书上予以注明。CNAS 建议实验室将不在认可范围内的意见或解释签发单独不带认可标识的报告或证书。

5.3.3.10 如果获准认可的校准实验室签发的校准证书被用于检测实验室、GB/T19001/ISO 9001 质量管理体系认证的组织建立测量溯源体系时，其校准证书应带认可标识。

5.3.3.11 对于实验室的安全认可，认可标识不能使用在证书或报告上，只能使用在用于宣传的媒介上，如网页、简介等。

5.3.3.12 实验室或检查机构不得将认可标识用于样品或产品（或独立的产品部件）上，使相关方误认为产品已获认证。

5.3.4 认可标识在校准标签上的使用

5.3.4.1 获准认可的校准实验室应建立签发认可标签的管理程序。

5.3.4.2 获准认可的校准实验室签发的带 CNAS 认可标识的校准标签可以加贴在被校准的仪器上，并且认可标识应置于标签上部的适当位置。

5.3.4.3 带 CNAS 认可标识的校准标签通常应包含以下信息：

- 1) 认可标识
- 2) 获准认可的校准实验室的名称或注册号
- 3) 仪器唯一性标识
- 4) 本次校准日期
- 5) 校准标签引用的校准证书

6. 国际互认联合标识的管理

6.1 IAF- MLA/CNAS 联合标识

6.1.1 IAF-MLA/CNAS 联合标识的式样

IAF-MLA 联合标识由 IAF-MLA 标识和 CNAS 认可标识并列组成。

6.1.1.1 当 IAF-MLA/CNAS 联合标识与认证机构徽标采用紧密使用方式时，采用以下式样，例如：



体系认证
CNAS CXXX - Q

6.1.1.2 当 IAF-MLA/CNAS 联合标识与认证机构徽标采用非紧密方式使用时, 采用以下式样, 例如:



体系认证
CNAS CXXX - Q

6.1.2 IAF-MLA/CNAS 联合标识的使用

6.1.2.1 获准认可的质量管理体系认证机构、环境管理体系认证机构可按本规则的规定使用 IAF-MLA/CNAS 联合标识, 其他机构不得使用。

6.1.2.2 获准认可的认证机构只有与 CNAS 签署书面协议后, 并取得专门许可和承诺遵守 CNAS 的使用规定时, 方可使用 IAF-MLA/CNAS 联合标识。

6.1.2.3 使用 IAF-MLA/CNAS 联合标识的认证机构不得提及或暗示 IAF 和 (或) CNAS 对其活动负责。

6.1.2.4 如果获准认可的认证机构向获证组织颁发“获证牌匾”时, 该牌匾中 IAF-MLA/CNAS 联合标识的使用应符合本规则的规定, 并应在正式使用前将“获证牌匾”样式提交 CNAS 备案。


6.1.2.5 获准认可的认证机构不得允许其认证的组织使用 IAF-MLA/CNAS 联合标识。

6.1.2.6 如果获准认可的认证机构因 IAF-MLA/CNAS 联合标识引起法律诉讼, 应及时通告 CNAS。如果采取法律行动, 应经 CNAS 准许。

6.2 ILAC-MRA/CNAS 联合标识

6.2.1 ILAC-MRA/CNAS 联合标识的式样

ILAC-MRA/CNAS 联合标识由 ILAC-MRA 标识和 CNAS 认可标识并列组成。例如:

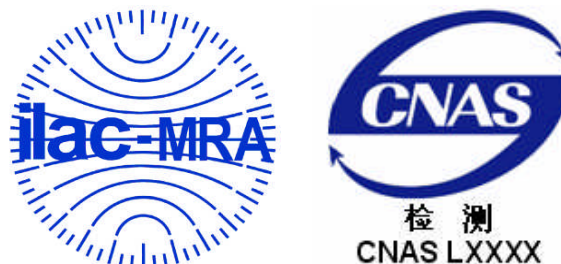

6.2.2 ILAC-MRA/CNAS 联合标识的使用

6.2.2.1 获准认可的检测、校准和医学实验室可按本规则的规定使用 IAF-MLA/CNAS 联

合标识，其他机构不得使用。

6.2.2.2 获准认可的检测、校准和医学实验室只有与 CNAS 签署书面协议后，并取得专门许可和承诺遵守 CNAS 的使用规定时，方可使用 ILAC-MRA/CNAS 联合标识。

6.2.2.3 使用 ILAC-MRA/CNAS 联合标识的检测、校准和医学实验室不得提及或暗示 ILAC 和（或）CNAS 对其活动负责。

6.2.2.4 除非 CNAS 与其他认可机构有特定的双边协议，否则检测、校准和医学实验室不得在签发的报告或证书上使用其他签署多边承认协议（MRA）认可机构的认可标识。

6.2.2.5 如果检测、校准和医学实验室因 ILAC-MRA/CNAS 联合标识引起法律诉讼，应及时通告 CNAS。如果采取法律行动，应经 CNAS 准许。

7. 认可状态的声明

7.1 获准认可的机构可以在报告、证书、文件、办公用品、宣传品、网页等上声明其认可状态。

7.2 获准认可的机构只能在认可证书有效期内作出认可状态声明，并用准确的文字表述被认可的能力范围，不得与其或其母体组织的其他活动有关。

7.3 认可状态声明不应产生误导，使客户误认为 CNAS 对获准认可的机构出具的结果及其意见或解释负责。

7.4 获准认可的实验室或检查机构不得将认可状态声明用于样品或产品（或独立的产品部件）上，使相关方误认为产品已获认证。

7.5 获准认可的认证机构不应因使用认可状态声明使相关方误认为 CNAS 对获得认证的特定管理体系、产品、服务、人员或过程等进行了批准。

7.6 获准认可的实验室或检查机构签发的带有认可状态声明的报告或证书应由授权签字人签发。

7.7 获准认可的实验室或检查机构在非认可范围内的所有活动中，包括分包活动，不得在相关的来往函件中含有认可状态声明的描述，其他相关的材料也不能提及或暗示获 CNAS 认可。

8. 认可证书的使用

8.1 获准认可的机构可以在公开出版物、文件、宣传品、网页等载体上展示认可证书，

展示的证书应清晰可辨。

8.2 当获准认可的机构的名称、地址、或 CNAS 的认可要求发生变化时，应向 CNAS 提出申请换发认可证书。当认可范围发生变化时，CNAS 将增发或重新签发认可证书附件，并在网页上及时公布。

8.3 获准认可的机构向客户展示的认可证书应在认可证书有效期内。在单独使用认可证书的部分文件时，应准确地表述其认可状态和认可范围，避免产生误导或歧义。

8.4 获准认可的机构被撤销认可资格后，应立即交还认可证书和认可标识章。

9.对于误用、滥用徽标、标识、认可证书以及误导性宣传行为的处理

9.1 为维护合格评定认可活动的信誉，CNAS 采取必要的措施防止任何机构和个人误用、滥用徽标、标识、认可证书以及误导宣传认可状态，并对相应事件做出处理。

9.2 CNAS 将根据获准认可的机构误用或滥用徽标、标识、认可证书以及误导宣传认可状态的情节轻重做出处理，包括：警告、暂停、撤销或提起法律诉讼。如果由于误用或滥用引起不良的影响，CNAS 将在有关的公开媒体上发布澄清声明。

9.3 已经被暂停、撤销认可资格的机构，如继续使用标识、认可证书或声明认可有效，CNAS 保留依据有关法律法规提起诉讼的权利。

9.4 获准认可的机构由于使用标识、认可证书或声明认可状态，引起或对其他机构提起的诉讼，未及时通告 CNAS，CNAS 将撤销其认可资格。必要时，CNAS 将依据有关法律法规对其提起诉讼。

9.5 被 CNAS 授权使用 CNAS 徽标的机构违反本规则的规定，CNAS 有权终止其与 CNAS 有关的活动，采用适当的方式向社会公示。必要时，CNAS 将依据有关法律法规对其提起诉讼。

10.附则

10.1 本规则经全体委员会审议通过，并由 CNAS 主任批准后实施。

10.2 本规则的修订和废止需履行相同的程序。

10.3 本规则由 CNAS 负责解释。